



Návod k použití

RadiForce® MS236WT-A

Barevný monitor LCD s dotykovým panelem

Důležité upozornění

Před použitím si přečtěte návod k použití a instalační příručku.

- Nastavení a seřízení monitoru je popsáno v instalační příručce.
- Nejnovější informace o výrobku včetně návodu k použití naleznete na našich webových stránkách.

www.eizoglobal.com

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Tato příručka a výrobek používají následující bezpečnostní symboly. Označují důležité informace. Pozorně si je přečtěte.

	Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudeš řídit, může dojít k vážnému poranění, včetně poranění smrtelného.
	Pokud se informacemi obsaženými v UPOZORNĚNÍ nebudeš řídit, může dojít k lehkému poranění nebo k poškození majetku či výrobku.
	Označuje varování nebo upozornění. Například  označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Označuje zakázanou činnost. Například  označuje zákaz rozebírání.

Tento výrobek byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán.
Při provozu mimo tuto oblast nemusí výrobek pracovat v souladu se svými technickými údaji.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího písemného svolení společnosti EIZO Corporation.


Společnost EIZO Corporation není povinna považovat za důvěrné jakékoliv získané materiály a informace bez předchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO Corporation o získání informací. Přes veškeré úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutí aktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že technické údaje výrobků EIZO mohou být změněny bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Důležité upozornění

Tento výrobek byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při provozu mimo tuto oblast nemusí výrobek pracovat v souladu se svými technickými údaji. V zájmu osobní bezpečnosti a správné údržby si pozorně přečtěte část BEZPEČNOSTNÍ POKYNY a výstražná upozornění na monitoru.

Umístění výstražného upozornění

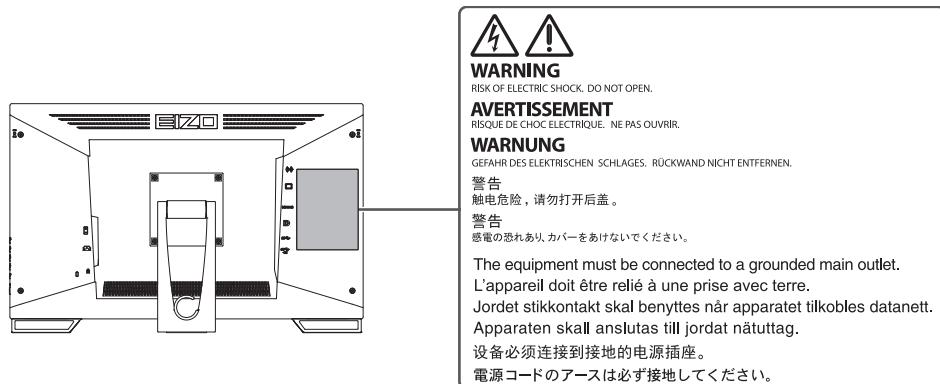

Symboly na přístroji

Symbol	Tento symbol označuje
○	Hlavní vypínač: Stiskem vypnete hlavní napájení monitoru.
-	Hlavní vypínač: Stiskem zapnete hlavní napájení monitoru.
⊕	Tlačítko napájení: Stiskem zapnete nebo vypnete napájení monitoru.
~	Střídavý proud
⚡	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
!	UPOZORNĚNÍ: Viz BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY [▶ 2]
☒	Značení OEEZ: Tento výrobek musí být likvidován odděleně; materiály lze recyklovat.
CE	Označení CE: Označení shody v souladu s ustanoveními směrnice a/nebo nařízení Rady (EU).
🏭	Výrobce
📅	Datum výroby
RXonly	Upozornění: Federální zákon Spojených států amerických stanoví, že toto zařízení smí prodávat nebo jeho prodej povolovat pouze licencovaný praktický lékař.
EU Medical Device	Zdravotnický prostředek v EU
EU Importer	Dovozce do EU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Symbol	Tento symbol označuje
UK CA	Značka souladu s předpisy Spojeného království
UK Responsible Person	Odpovědná osoba pro Spojené království
CH REP	Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Pokud z přístroje začne vycházet kouř, zápar spáleniny či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré napájecí kabely a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.

Pokud se pokusíte vadný přístroj dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

Přístroj nedemontujte ani neupravujte.

Otevření skříně přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem nebo popálení od částí s vysokou teplotou. Úpravy přístroje mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ

Přenechte veškerý servis kvalifikovanému personálu.

Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku. Při otevření nebo odebrání krytů hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

Zabraňte vniknutí cizích předmětů nebo kapalin do vnitřku přístroje.

Kovové předměty, hořlavé materiály nebo kapaliny, které vniknou do skříně přístroje, mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Pokud dojde ke vniknutí kapalin do skříně přístroje, ihned jej odpojte. Než začnete přístroj znova používat, nechejte jej zkонтrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

VAROVÁNÍ

Umístěte přístroj na pevný a stabilní povrch.

Při nevhodném umístění přístroje hrozí jeho pád s následkem úrazu.

Pokud dojde k pádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. Poškozený přístroj dále nepoužívejte. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ

Používejte přístroj na vhodném místě.

V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

- Neumísťujte přístroj do venkovního prostředí.
- Neumísťujte přístroj do žádného dopravního prostředku (lodí, letadel, vlaků, automobilů apod.).
- Neumísťujte přístroj do prašných nebo vlhkých prostředí.
- Neumísťujte přístroj na místa, na kterých by na obrazovku dopadala voda (koupelny, kuchyně apod.).
- Neumísťujte přístroj na místa, v nichž by obrazovka mohla být přímo vystavena páře.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.
- Neumísťujte výrobek na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
- Neumísťujte přístroj do prostředí obsahujícího hořlavý plyn.
- Neumísťujte v prostředích s výskytem korozivních plynů (např. oxid siřičitý, sirovodík, oxid dusičitý, chlór, čpavek a ozón).
- Neumísťujte do prostředí s výskytem prachu a složek urychlujících korozi v prostředí (např. chlorid sodný a síra), vodivých kovů apod.



⚠ VAROVÁNÍ

Udržujte plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení.

⚠ VAROVÁNÍ

Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej k elektrické zásuvce odpovídající technickým předpisům dané země.

Je nutno používat v rámci jmenovitého napětí napájecího kabelu. V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Zdroj napájení: 100–240 VAC 50/60 Hz

⚠ VAROVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel, pevně uchopte zástrčku a zatáhněte za ni.

Při tahání za kabel hrozí jeho poškození s důsledkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj musí být připojen k uzemněné napájecí zásuvce.

V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.



⚠ VAROVÁNÍ**Použijte správné napětí.**

- Tento přístroj je určen k použití pouze s určitou hodnotou napětí. Při připojení k jinému napětí než je uvedeno v tomto návodu k použití hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Zdroj napájení: 100–240 VAC 50/60 Hz
- Nepřetěžujte napájecí obvod, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ**S napájecím kabelem manipulujejte opatrně.**

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty a za napájecí kabel netahejte. Při používání poškozeného napájecího kabelu hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.


⚠ VAROVÁNÍ**Když se uživatel dotýká výrobku, nesmí se zároveň dotýkat pacienta.**

Tento výrobek není určen k tomu, aby se jej dotýkali pacienti.


⚠ VAROVÁNÍ**Za bouřky se nikdy nedotýkejte zástrčky ani napájecího kabelu.**

Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.


⚠ VAROVÁNÍ**Při připevňování stojanu s ramenem postupujte podle uživatelské příručky ke stojanu s ramenem a zajistěte bezpečnou instalaci přístroje.**

V opačném případě může dojít k uvolnění přístroje, což může vést k úrazu a poškození zařízení.

Před instalací zkонтrolujte, zda mají stoly, stěny nebo jakýkoli jiný instalační povrch dostatečnou mechanickou pevnost.

Pokud dojde k pádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. Poškozený přístroj dále nepoužívejte. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem. Při připevňování sklápěcího stojanu použijte originální šrouby a pevně je utáhněte.

⚠ VAROVÁNÍ**Nedotýkejte se poškozeného LCD panelu holýma rukama.**

Pokud dojde k přímému kontaktu kůže s panelem, zasažená místa důkladně omyjte.

Pokud kapalné krystaly vniknou do očí nebo do úst, ihned je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V opačném případě můžete utrpět toxickou reakci.


⚠ VAROVÁNÍ**Pokud budete přístroj instalovat ve výšce, požádejte o pomoc odborníka.**

Při instalaci monitoru ve výšce hrozí pád výrobku nebo jeho částí s následkem úrazu. Při instalaci monitoru nebo kontrole poškození nebo deformací výrobku před instalací a po instalaci monitoru požádejte o pomoc nás nebo odborníka na stavební práce.

UPOZORNĚNÍ

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před použitím zkонтrolujte provozuschopnost.

Před použitím ověřte, zda nedochází k žádným problémům se zobrazeným obrazem.

Při používání více přístrojů před použitím zkонтrolujte, zda se obrazy zobrazují správně.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Bezpečně připevněte kabely a vodiče, které lze připevnit.

Řádně nepřipevněné kabely a vodiče se mohou odpojit a v důsledku toho může být obraz přerušen a vaše činnost může být přerušena.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před přemístěním přístroje od něj odpojte kabely a příslušenství.



V opačném případě se mohou kabely a příslušenství během přemisťování odpojit a způsobit poranění osob.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Přístroj přenášejte a umísťujte v souladu s určenými postupy.

- Při přemisťování výrobku držte pevně spodek monitoru.
- Monitory velikosti 30 palců a více jsou těžké. Vybalování nebo přenášení monitoru musí provádět alespoň dvě osoby.
- Pokud se na zadní straně monitoru nachází držadlo, uchopte a pevně držte spodek monitoru a jeho držadlo.

Při pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození zařízení.

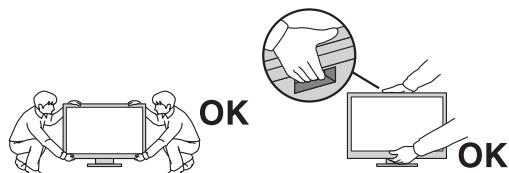

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli ruce.

Pokud náhle zatlačíte silou na monitor, když upravujete jeho výšku nebo úhel, můžete si přivrtit nebo poranit ruce.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nezakrývejte větrací otvory na skříni.

- Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
- Tento přístroj neinstalujte na nedostatečně větrané místo ani na místo s nedostatkem prostoru.
- Nepoužívejte přístroj v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.

Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se zástrčky napájení mokrýma rukama.

Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Nepokládejte do blízkosti zástrčky napájení žádné předměty.

Tím bude zajištěno snadné odpojení zástrčky napájení v případě problému a zabráni se požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Pravidelně čistěte okolí zástrčky napájení a větracího otvoru monitoru.

Ulpěný prach, voda nebo olej v této oblasti může způsobit požár.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před čištěním přístroje jej odpojte.

Při čištění přístroje zapojeného do elektrické zásuvky hrozí úraz elektrickým proudem.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, za účelem úspory energie a zvýšení bezpečnosti přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájení od elektrické zásuvky.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek zlikvidujte v souladu se zákony místa nebo země bydliště.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele na území EHP a Švýcarska:

Každá vážná přihoda, ke které došlo v souvislosti s tímto zařízením, musí být oznámena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient sídlo.

Upozornění k tomuto monitoru

Určené použití

Tento výrobek je vhodný pro klinické zkoušky. Nepodporuje zobrazení mamografických snímků pro diagnostické účely.

Upozornění

- Při použití tohoto přístroje k výše uvedeným účelům musí být přístroj v režimu zobrazení na šířku.
- Na jiná použití tohoto výrobku než popsaná v této příručce se nemusí vztahovat záruka.
- Specifikace uvedené v této příručce se uplatní pouze tehdy, pokud používáte napájecí kabely dodané s výrobkem a signálové kably stanovené společností EIZO.
- S tímto výrobkem používejte pouze příslušenství EIZO stanovené společností EIZO.

Zásady používání

- Fungování některých dílů (jako je LCD panel a ventilátor) se může po delším používání zhoršit. Pravidelně kontrolujte, že správně fungují.
- Při změně zobrazení po dlouhodobém zobrazení téhož obrazu může na obrazovce zůstat paobraz. Zabraňte dlouhodobému zobrazení téhož obrazu použitím spořiče displeje nebo funkce úspory energie. Paobraz se může objevit i po krátké době v závislosti na zobrazeném obrazu. Tento jev lze odstranit tak, že zobrazíte jiný obraz nebo na několik hodin vypnete napájení.
- Stabilizace displeje monitoru trvá přibližně 30 minut. Po zapnutí napájení monitoru nebo po jeho probuzení z režimu úspory energie vyčkejte alespoň 30 minut, než začnete monitor seřizovat.
- Pokud je na displeji dlouho jeden obraz, mohou se na něm vytvořit tmavé skvrny nebo vypálená místa. Aby se prodloužila životnost monitoru, doporučujeme jeho pravidelné vypínání.
- Životnost podsvícení LCD panelu je omezená. V závislosti na způsobu použití, například v případě nepřetržitého dlouhodobého použití, se může životnost podsvícení zkrátit a může být nutné jej vyměnit. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
- Obrazovka může obsahovat vadné obrazové body nebo malý počet trvale svítících obrazových bodů. Tento jev je způsoben vlastnostmi LCD panelu a nejedná se o poruchu přístroje.
- Zabraňte poškrábání nebo působení tlaku na LCD panel jakýmkoliv ostrým předmětem, mohlo by dojít poškození LCD panelu. Nepokoušejte se čistit panel papírovými kapesníčky, mohlo by dojít k jeho poškrábání.
- Na povrchu nebo vnitřku tohoto přístroje, když je přenesen do chladné místnosti, když teplota náhle stoupne nebo když je přemístěn z chladné místnosti do teplé místnosti, se může tvořit kondenzace. V takovém případě výrobek nezapínejte. Před zapnutím výrobku vyčkejte, až se kondenzace odpaří. V opačném případě hrozí poškození výrobku.
- (Upozornění k použití dotykového panelu)
Při dotykovém ovládání
dávejte pozor na následující okolnosti. V opačném případě můžete monitor poškodit.
 - Na dotykový panel netlačte silou, nepoškrábejte jeho povrch ani do panelu nešťouchejte.

- Nedotýkejte se dotykového panelu tvrdými předměty, jako jsou kuličková pera nebo kovy.

Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru

Čištění

- Za účelem zachování dobrého vzhledu výrobku a prodloužení jeho životnosti doporučujeme jej pravidelně čistit.
- Skvrny na výrobku lze odstranit jemným setřením kouskem měkké tkaniny namočené ve vodě nebo pomocí sady ScreenCleaner.

Upozornění

- Zabraňte přímému styku kapaliny s výrobkem. Dojde-li ke styku s kapalinou, ihned ji setřete.
- Zabraňte vniknutí kapaliny do mezer nebo vnitřku výrobku.
- Chemikálie určené k čištění nebo dezinfekci, jako je alkohol a dezinfekční prostředek, mohou způsobit změnu lesku, zmatnění, zesvětlení výrobku a také zhoršení kvality obrazu. Nepoužívejte chemikálie příliš často.
- Nikdy nepoužívejte ředitla, benzen, vosky nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou výrobek poškodit.
- Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na našich webových stránkách.
Jak najít informace: Navštivte stránku www.eizoglobal.com a do pole pro hledání na webu zadejte výraz „disinfect“.

Dezinfekce chemikáliemi

- Při dezinfekci výrobků doporučujeme používat námi otestované chemikálie (viz následující tabulka). Upozorňujeme, že použití těchto chemikálí není zárukou, že se výrobek nepoškodí nebo se nezhorší jeho funkčnost.

Kategorie	Typ chemikálie	Příklad výrobcu
Na bázi alkoholu	Francovka (ethylalkohol)	Etanol
Na bázi alkoholu	Isopropanol	Isopropylalkohol (IPA)
Chlór	Chlornan sodný	Purelox
Biguanid	Chlorhexidin glukonát	Roztok Hibitane
Na bázi alkoholu	Benzalkoniumchlorid	Welpas
Na bázi aldehydu	Glutaraldehyd	Sterihyde
Na bázi aldehydu	Glutaraldehyd	Cidex Plus28
Amfoterická povrchově aktivní látka	Alkyldiaminoethylglycin hydrochlorid	Roztok satenidinu

Pohodlné používání monitoru

- Příliš tmavá nebo světlá obrazovka může poškodit váš zrak. Nastavení jasu monitoru přizpůsobte okolním podmínkám.
- Dlouhodobé sledování monitoru způsobuje únavu očí. Každou hodinu si udělejte 10minutovou přestávku.
- Dívejte se na obrazovku ze správné vzdálenosti a úhlu.

Varování a odpovědnost související se zabezpečením dat

- Aktualizaci firmwaru provádějte pouze ve spolupráci se společností EIZO Corporation nebo jejím distributorem.
- Pokud EIZO Corporation nebo její distributor vydá pokyn k aktualizaci firmwaru, učiňte tak neprodleně.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Důležité upozornění	3
Umístění výstražného upozornění	3
Symboly na přístroji	3
Upozornění k tomuto monitoru.....	10
Určené použití	10
Zásady používání	10
Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru	11
Čištění.....	11
Dezinfekce chemikáliemi	12
Pohodlné používání monitoru	12
Varování a odpovědnost související se zabezpečením dat	12
1 Úvod	15
1.1 Funkce	15
1.1.1 Dokonale plochá obrazovka.....	15
1.1.2 Snadno použitelné nastavení stojanu	15
1.1.3 Podpora 10bodového dotykového ovládání.....	15
1.2 Obsah balení.....	16
1.2.1 Součástí balení je disk EIZO LCD Utility Disk.....	16
1.3 Ovládací prvky a funkce	17
1.3.1 Přední strana	17
1.3.2 Zadní strana.....	18
2 Instalace a připojení.....	19
2.1 Před instalací	19
2.1.1 Podmínky instalace.....	19
2.2 Instalace.....	19
2.3 Připojení kabelů	19
2.4 Zapnutí napájení	21
2.5 Nastavení úhlu sklonu obrazovky	22
2.6 Montáž držáku dotykového pera	22
2.7 Nastavení dotykového panelu.....	22
3 Žádný obraz	24
4 Technické údaje	26
4.1 Seznam technických údajů	26
4.1.1 LCD panel.....	26
4.1.2 Dotykový panel	26
4.1.3 Video signály.....	26

OBSAH

4.1.4	USB.....	26
4.1.5	Zvuk	27
4.1.6	Napájení.....	27
4.1.7	Fyzické parametry.....	27
4.1.8	Požadavky na provozní prostředí	27
4.1.9	Podmínky přepravy a skladování.....	27
4.2	Kompatibilní rozlišení	28
4.3	Příslušenství.....	28
Příloha	29
Zdravotnická norma	29	
Klasifikace zařízení	29	
Informace o elektromagnetické kompatibilitě	30	
Prostředí, pro které je tento produkt určen	30	
Technický popis	31	


1 Úvod

Děkujeme vám za váš výběr barevného monitoru LCD EIZO.

1.1 Funkce


1.1.1 Dokonale plochá obrazovka

Monitor disponuje dokonale plochou obrazovkou s plochým rámečkem. Obrazovku lze ovládat dotykem až po okraj.

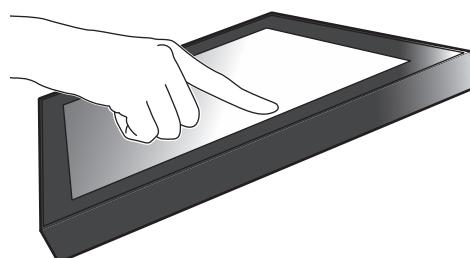


1.1.2 Snadno použitelné nastavení stojanu

Úhel sklonu monitoru lze nastavit spojité. Polohu obrazovky lze změnit spojitě, takže můžete monitor používat způsobem, který vám vyhovuje, například pro kancelářské použití nebo vícedotykové ovládání.

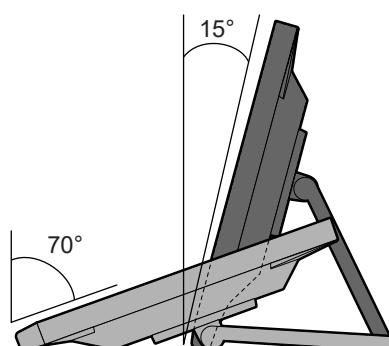

1.1.3 Podpora 10bodového dotykového ovládání

Vícedotykové ovládání lze použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení a k otočení zobrazení. Obrazovka reaguje na jemné dotyky, takže umožňuje snadno provádět pohyby a posuny prstem.

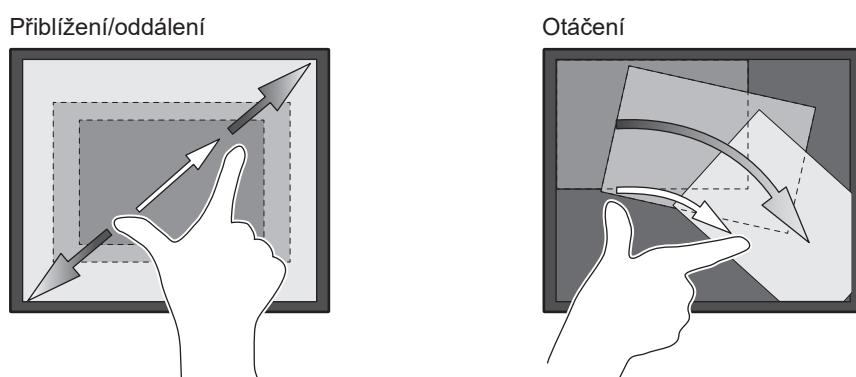

1.2 Obsah balení

Ověřte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud nějaké položky chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte místního prodejce nebo zástupce společnosti EIZO uvedeného na přiloženém listu.

Poznámka

- Doporučujeme uschovat krabici a obalový materiál pro případ budoucího přemístování nebo převážení výrobku.

- Monitor
- Napájecí kabel



- Digitální signálový kabel (DisplayPort - DisplayPort): 1 × PP300



- 1× kabel HDMI (HDMI/HDMI) HH300PR



- Kabel USB: 1× UU300SS



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Návod k použití
- 1× čisticí utěrka
- 1× dotykové pero
- 1× držák dotykového pera
- 1× šroub držáku dotykového pera
- 2× kryt otvoru šroubu
- 1× stahovací páska (se zavakávacím klipem)


1.2.1 Součástí balení je disk EIZO LCD Utility Disk

Disk CD-ROM obsahuje následující položky. Postup spuštění softwaru a přístupu k souborům najdete v souboru „Readme.txt“ na disku.

- Soubor Readme.txt
- Ovladač dotykového panelu (DMT-DD)
- Software pro nastavení citlivosti dotykového panelu (TPOffset)
- Uživatelské příručky
 - Návod k použití tohoto monitoru
 - Příručka k instalaci monitoru
 - Uživatelská příručka ovladače dotykového panelu
 - Uživatelská příručka softwaru pro nastavení citlivosti dotykového panelu
- Vnější rozměry

1.3 Ovládací prvky a funkce


1.3.1 Přední strana

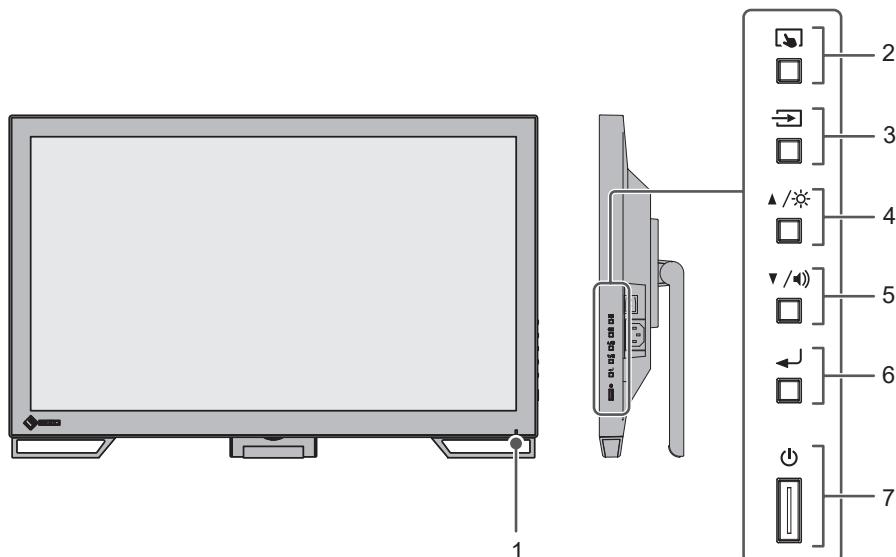

1. Indikátor napájení	Udává provozní stav monitoru. Modrá: Zobrazení na obrazovce Oranžová: Režim úspory energie Zhasnuto: Vypnuté hlavní napájení
2. Tlačítko 	Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat dotykový panel a nastavit jeho citlivost.
3. Tlačítko 	Slouží k přepínání vstupních signálů zobrazení.
4. Tlačítko *1	Slouží k výběru položek v nabídce Nastavení, k úpravě nebo nastavení funkcí a zobrazení obrazovky nastavení jasu.
5. Tlačítko *1	Slouží k výběru položek v nabídce Nastavení, úpravě nebo nastavení funkcí a zobrazení obrazovky nastavení hlasitosti.
6. Tlačítko 	Umožňuje zobrazit nabídku Nastavení, potvrdit položky nastavení v jednotlivých nabídkách a uložit výsledky nastavení.
7. Tlačítko 	Vypíná a zapíná napájení.

*1 V této příručce může být tlačítko zobrazeno jako a tlačítko jako .

1.3.2 Zadní strana

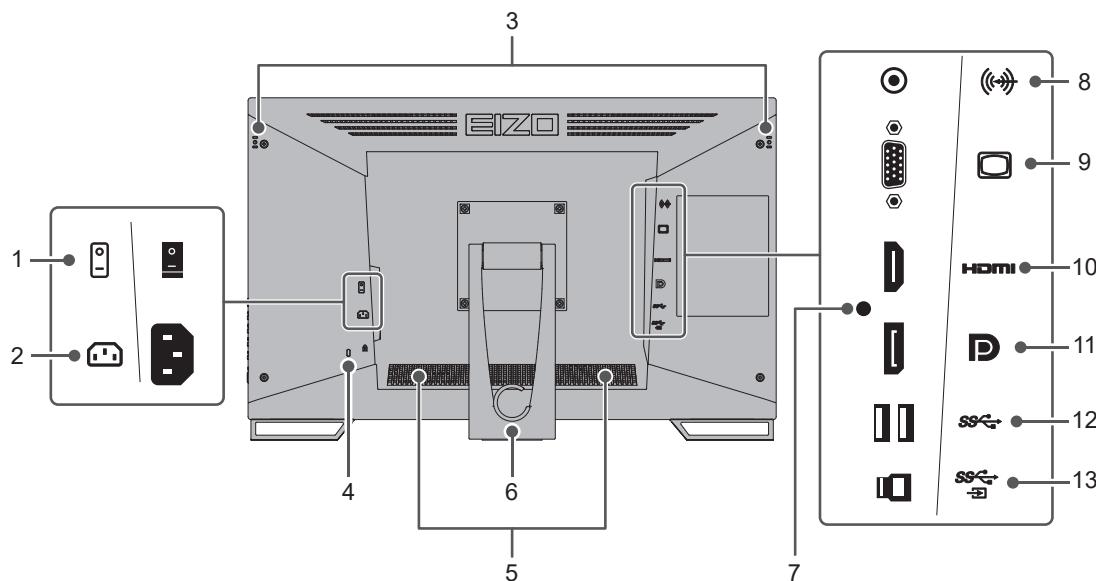

1. Hlavní vypínač napájení	Slouží k vypnutí a zapnutí hlavního napájení. : Zapnuto, ○: vypnuto
2. Napájecí konektor	Slouží k připojení napájecího kabelu.
3. Otvor pro držák dotykového pera	Slouží k upevnění držáku dotykového pera. (Viz 2.6 Montáž držáku dotykového pera [▶ 22] .)
4. Zásuvka bezpečnostního zámku	Splňuje požadavky systému zabezpečení MicroSaver společnosti Kensington.
5. Reproduktory	Slouží k výstupu zvuku.
6. Stojan (s držákem kabelu)	Umožňuje nastavení úhlu sklonu.
7. Otvor pro upevnění stahovací pásky	Upevněním stahovací pásky zabráníte odpojení kabelu HDMI.
8. Stereofonní konektor mini jack	Připojením externího zařízení pomocí stereofonního konektoru mini jack můžete v monitoru přehrávat externí zvuk.
9. 15kolíkový (mini) konektor D-Sub	Slouží k připojení k počítači vybavenému výstupem D-Sub.
10. Konektor HDMI	Slouží k připojení k počítači vybavenému výstupem HDMI.
11. Konektor DisplayPort	Slouží k připojení k počítači vybavenému výstupem DisplayPort.
12. Konektor USB-A (příchozí)	Slouží k připojení k perifernímu zařízení USB.
13. Konektor USB-B (odchozí)	Slouží k připojení ke kabelu USB, pokud je monitor používán jako dotykový panel nebo pokud je použita funkce rozbočovače USB.

2 Instalace a připojení

2.1 Před instalací

Pečlivě si přečtěte část **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ▶ 3** a tyto pokyny vždy dodržujte.

Pokud umístíte tento výrobek na lakovaný povrch, barva může v důsledku složení pryže přilnout ke spodní straně stojanu. Před použitím zkонтrolujte plochu stolu.

2.1.1 Podmínky instalace


Pokud instalujete monitor do stojanu, zkонтrolujte, že je po stranách a nad monitorem dostatek volného prostoru.

Upozornění

- Monitor umístěte tak, aby obrazovku nerušilo žádné světlo.

2.2 Instalace

Položte měkkou látku nebo podobný materiál na stabilní plochu a otevříte stojan, dokud neuslyšíte cvaknutí.

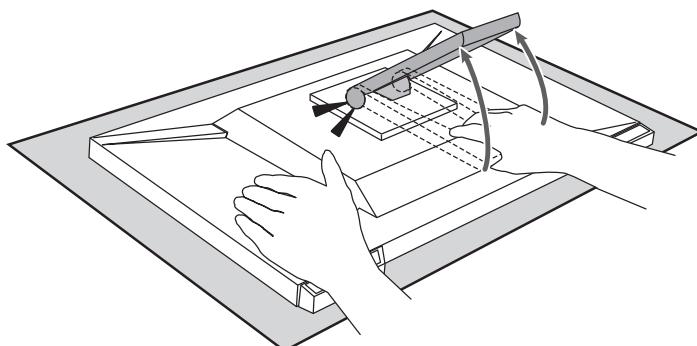

Upozornění

- Nepoužívejte monitor, když je v obalu.
Když je monitor v obalu, je stojan zavřený, takže existuje riziko pádu monitoru.

2.3 Připojení kabelů

Upozornění


- Zkontrolujte, že je vypnutý monitor, počítač i periferní zařízení.
- Při nahradě stávajícího monitoru za tento monitor postupujte podle informací v kapitole **4.2 Kompatibilní rozlišení ▶ 28**. V této kapitole je popsán postup změny nastavení rozlišení a svislého kmitočtu rozkladu v počítači na hodnoty podporované tímto monitorem. Změny je třeba provést před připojením počítače.

1. Připojte signálové kabely.

Zkontrolujte tvary konektorů a připojte kabely. Při pripojování kabelu HDMI upevněte kabel pomocí dodané stahovací pásky. Při pripojování kabelu s 15kolíkovým mini konektorem D-Sub zajistěte konektor utažením šroubků.

Pokud výrobek používá jako monitor s dotykovým panelem, připojte k němu kabel USB. Připojením povolíte funkci rozbočovače USB.

Kabel pro stereofonní konektor mini jack se používá tehdy, pokud potřebujete přehrávat zvuk z reproduktorů monitoru a k připojení používáte kabel s 15kolíkovým mini konektorem D-Sub.

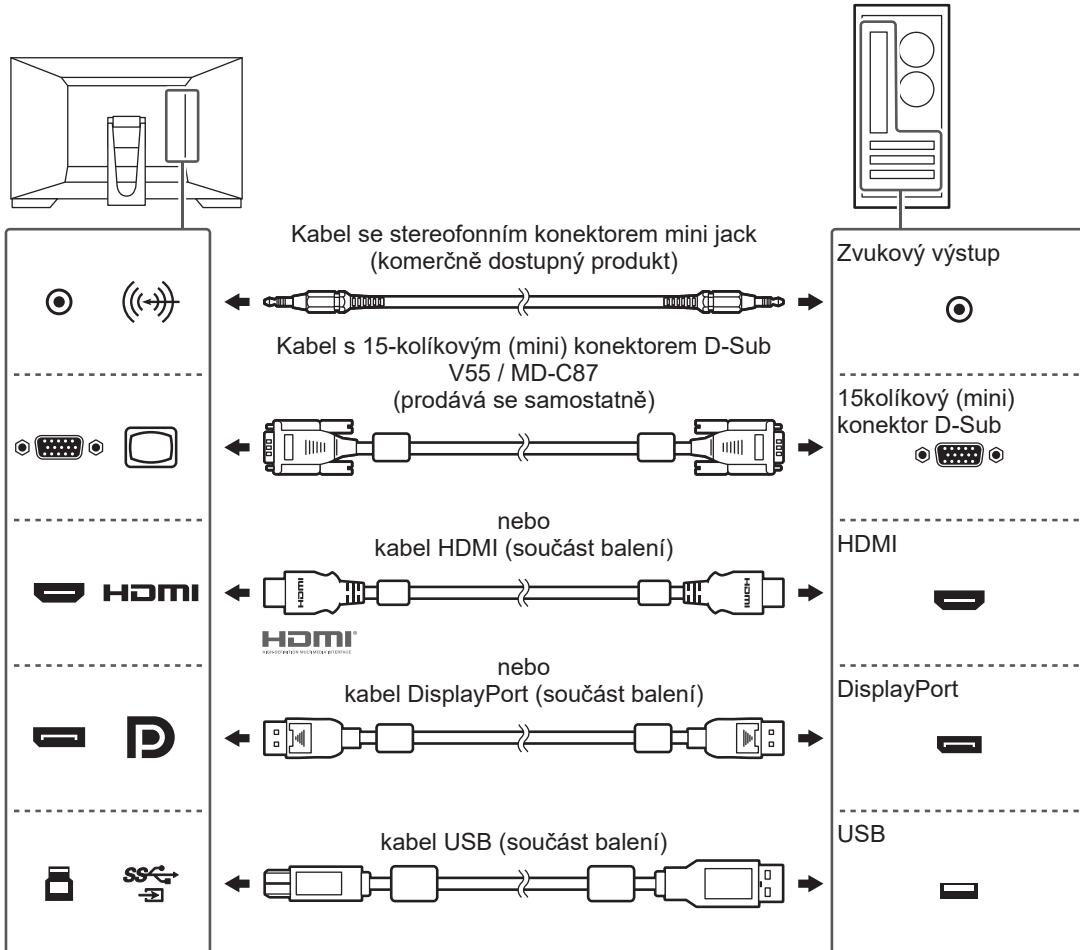


Upozornění

- Při pripojování k více počítačům zapněte vstupní signál. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.

Poznámka

- Pokud je zapojení kabelů obtížné, upravte si sklon monitoru.

2. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce a k napájecímu konektoru na monitoru.
Konektor napájecího kabelu do monitoru zasuňte celou délkou.

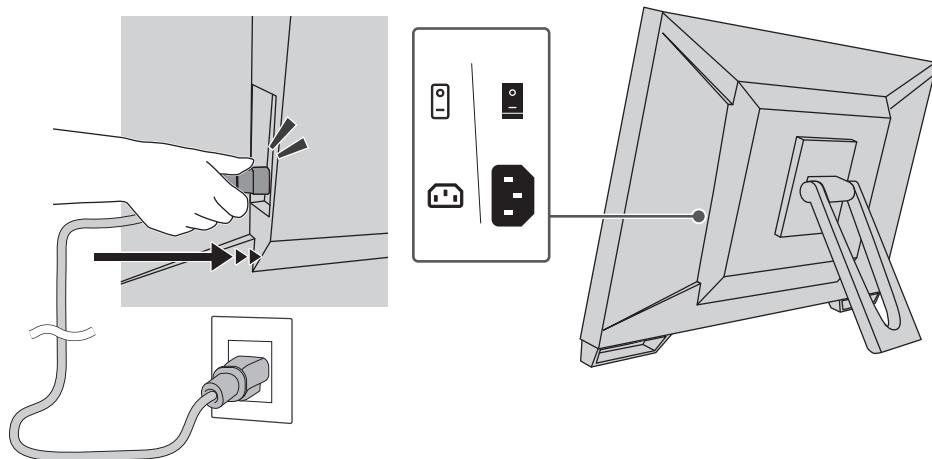

2.4 Zapnutí napájení

1. Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte monitor.
Indikátor napájení se rozsvítí modře.
Pokud indikátor nesvítí, viz [3 Žádný obraz \[► 24\]](#).
3. Zapněte počítač.
Na obrazovce se objeví obraz.
Pokud se obraz neobjeví, informace o řešení problému najdete v části [3 Žádný obraz \[► 24\]](#).

Upozornění


- V závislosti na nastavení počítače se obraz nemusí zobrazit správně nebo nemusí mít správné měřítko. Je-li to potřebné, zkontrolujte nastavení počítače.
- K zajištění maximální úspory energie doporučujeme zařízení vypínat tlačítkem napájení. Pokud monitor nepoužíváte, můžete jej zcela odpojit od napájení vypnutím hlavního zdroje napájení nebo odpojením zástrčky napájení.

Poznámka

- Dodržováním následujících zásad lze maximálně prodloužit životnost monitoru omezením degradace jasu a snížením spotřeby:
 - Používejte funkci úspory energie počítače nebo monitoru.
 - Pokud monitor nepoužíváte, vypněte je.

2.5 Nastavení úhlu sklonu obrazovky

Oběma rukama uchopte levý a pravý okraj monitoru a nastavte sklon obrazovky do optimální polohy podle svých požadavků.

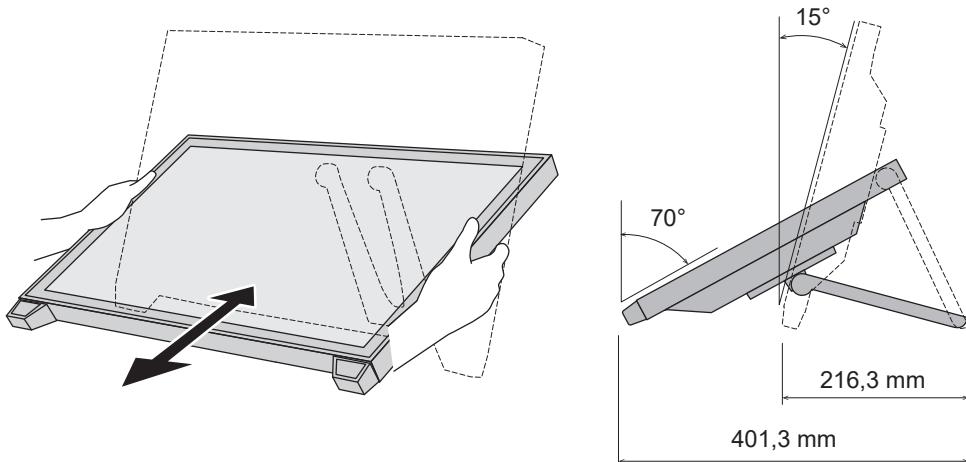


Upozornění

- Po provedení úprav zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojené.

2.6 Montáž držáku dotykového pera


Držák dotykového pera upevněte do jednoho z otvorů vlevo a vpravo na zadní straně monitoru. K upevnění držáku použijte šroub pro upevnění držáku dotykového pera.

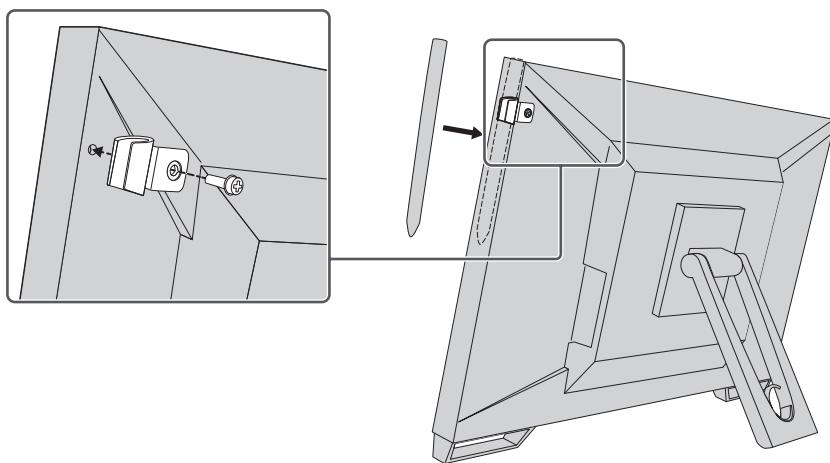

2.7 Nastavení dotykového panelu

Připojte kabel USB a po dokončení instalace spusťte software pro nastavení citlivosti TPOffset.

Software TPOffset je součástí disku EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

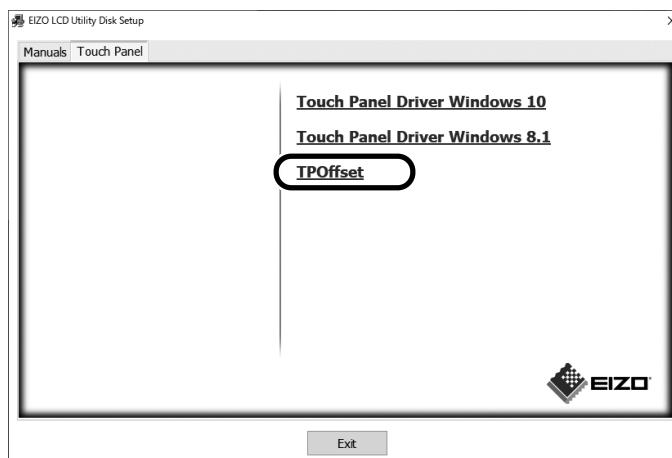

Poznámka

- Software TPOffset můžete také stáhnout z našich webových stránek. (www.eizoglobal.com)
- Software TPOffset spusťte podle potřeby v těchto případech:
 - V případě významné změny prostředí použití
 - V případě zjevné změny použitelnosti
 - V případě potíží s dotykovým ovládáním, například pokud se kurzor posunuje nebo přeskakuje

3 Žádný obraz

Indikátor napájení nesvítí.

- Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.
- Zapněte hlavní vypínač.
- Stiskněte .
- Vypněte hlavní napájení a po několika minutách je opět zapněte.

Indikátor napájení svítí: Modrá

- V nabídce Settings (Nastavení) zvyšte hodnoty položek „Brightness“, „Contrast“ nebo „Gain“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.

Indikátor napájení svítí: oranžově

- Pomocí tlačítka  přepněte vstupní signál.
- V nabídce „Administrator Settings“ proveděte nastavení „On“ na „Compatibility Mode“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.
- Pohněte myší nebo stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici.
- Dotkněte se dotykového panelu.
- Ověřte, zda je počítač zapnutý.
- Vypněte hlavní vypínač a poté jej opět zapněte.

Indikátor napájení bliká: oranžově

- Tento problém se může objevit, když je počítač připojen prostřednictvím konektoru DisplayPort. K připojení použijte námi doporučený signálový kabel. Vypněte a zapněte monitor.
- Zkontrolujte připojení a stav periferních zařízení USB připojených k monitoru.

Na obrazovce je zobrazena zpráva „No Signal“


Příklad:



- Zpráva výše se může zobrazit, protože některé počítače nevysílají signál ihned po zapnutí.
- Ověřte, zda je počítač zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel. Připojte signálové kably ke konektorům příslušného vstupního signálu.
- Pomocí tlačítka  přepněte vstupní signál.
- Vypněte hlavní vypínač a poté jej opět zapněte.
- Zkuste nastavit možnost „Auto Input Detection“ v nabídce „Administrator Settings“ na hodnotu „Off“ a ručně přepnout vstupní signál. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD-ROM.

Na obrazovce je zobrazena zpráva „Signal Error“

Příklad:



- Zkontrolujte, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům monitoru na rozlišení a svislý kmitočet rozkladu (viz [4.2 Kompatibilní rozlišení ▶ 28](#)).
- Restartujte počítač.
- Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů uživatelské příručky grafického adaptéru.

4 Technické údaje

4.1 Seznam technických údajů

4.1.1 LCD panel

Typ	IPS (matný)
Podsvícení	LED
Velikost	23,0 palce (58,4 cm)
Rozlišení	1920 sloupců × 1080 řádků
Viditelná oblast (h × v)	509,2 mm × 286,4 mm
Rozteč obrazových bodů	0,265 mm × 0,265 mm
Zobrazené barvy	8bitové barvy: 16,77 milionů barev
Pozorovací úhly (h × v, typicky)	178° / 178°
Kontrastní poměr (typicky)	1000:1
Doba odezvy (obvyklá)	11 ms (oblast středního tónu)

4.1.2 Dotykový panel

Povrchová úprava	Matná
Tvrdost povrchu	5H
Způsob komunikace	Přenos USB
Metoda detekce	Projektovaná kapacitní technologie
Podporovaný operační systém ^{*1}	Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 (32/64 bitů) Microsoft Windows 8.1 (32/64 bitů)
Počet simultánních dotykových bodů	Max. 10 bodů

^{*1} Podpora společnosti EIZO bude ukončena, jakmile bude ukončena podpora dodavatele operačního systému.

4.1.3 Video signály

Vstupní konektory		1× DisplayPort (kompatibilní s HDCP 1.3), 1× HDMI (kompatibilní s HDCP 1.4) ^{*1} , 1× 15kolíkový (mini) konektor D-Sub
Obnovovací kmitočet v digitálním režimu (H/V ^{*2})	DisplayPort	31 kHz – 68 kHz / 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (při rozlišení 720 × 400)
	HDMI	31 kHz – 68 kHz / 49 Hz – 51 Hz, 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (při rozlišení 720 × 400)
Obnovovací kmitočet v analogovém režimu (H/V ^{*2})	D-Sub	31 kHz až 81 kHz / 55 Hz až 76 Hz
Režim synchronizace snímků		49 Hz – 61 Hz
Maximální taktovací kmitočet		148,5 MHz

^{*1} Ovládání HDMI CEC (nebo vzájemné ovládání) není podporováno.

^{*2} Podporovaný svislý kmitočet rozkladu se liší dle rozlišení. Další informace viz [4.2 Kompatibilní rozlišení \[▶ 28\]](#).

4.1.4 USB

Port	Příchozí (upstream)	1 porty USB-B
------	---------------------	---------------

	Odchozí (downstream)	2 porty USB-A
Standard		Specifikace USB rev. 3.1 gen. 1
Rychlosť komunikace		5 Gb/s (velmi vysoká), 480 Mb/s (vysoká), 12 Mb/s (plná), 1,5 Mb/s (nízká)
Napájecí proud	Odchozí (USB-A)	Max. 900 mA na port

4.1.5 Zvuk

Formát zvukového vstupu	DisplayPort	Dvoukanálová lineární modulace PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)
	HDMI	Dvoukanálová lineární modulace PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)
Reproduktory		1 W + 1 W
Vstupní konektory		1x stereofonní konektor mini jack 1x DisplayPort, 1x HDMI (každý sdílený s videosignálem)

4.1.6 Napájení

Vstup	100–240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz, 0,80–0,45 A
Maximální příkon	47 W nebo méně
Režim úspory energie	0,5 W nebo méně ^{*1}
Pohotovostní režim	0,3 W ^{*1}

^{*1} Není připojen žádný odchozí port USB, nastavení „Administrator Settings“ – „Compatibility Mode“ jsou v poloze „Off“, není připojena žádná externí zátěž a zachovávají se výchozí nastavení.

4.1.7 Fyzické parametry

Rozměry (Š × V × H)	556,7 mm × 143,9 mm × 401,3 mm (sklon: 70°) 556,7 mm × 353,9 mm × 216,3 mm (sklon: 15°)
Rozměry (š × v × h) (bez stojanu)	556,7 mm × 339,2 mm × 54,0 mm
Čistá hmotnost	Přibližně 6,6 kg
Čistá hmotnost (monitor)	Přibližně 6,0 kg
Sklon	15°–70°

4.1.8 Požadavky na provozní prostředí

Teplota	5 °C – 35 °C
Vlhkost	20 % – 80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	540 hPa – 1060 hPa

4.1.9 Podmínky přepravy a skladování

Teplota	-20 °C – 60 °C
Vlhkost	10 % – 92 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	200 hPa – 1060 hPa

4.2 Kompatibilní rozlišení

Monitor podporuje následující rozlišení:

✓: Podporováno, -: nepodporováno

Rozlišení	Svislý kmitočet rozkladu (Hz)	DisplayPort	HDMI	D-Sub
640 × 480	59,940	✓	✓	✓
640 × 480	60,000	✓	✓	-
640 × 480	72,809	-	-	✓
640 × 480	75,000	-	-	✓
720 × 400	70,087	✓	✓	✓
720 × 480	59,940	✓	✓	-
720 × 480	60,000	✓	✓	-
720 × 576	50,000	-	✓	-
800 × 600	56,250	-	-	✓
800 × 600	60,317	✓	✓	✓
800 × 600	72,188	-	-	✓
800 × 600	75,000	-	-	✓
1024 × 768	60,004	✓	✓	✓
1024 × 768	70,069	-	-	✓
1024 × 768	75,029	-	-	✓
1280 × 720	50,000	-	✓	-
1280 × 720	59,940	✓	✓	-
1280 × 720	60,000	✓	✓	✓
1280 × 960	60,000	✓	✓	✓
1280 × 1024	60,020	✓	✓	✓
1280 × 1024	75,025	-	-	✓
1680 × 1050	59,883	✓	✓	✓
1680 × 1050	59,954	✓	✓	✓
1920 × 1080 ^{*1}	50,000	-	✓	-
1920 × 1080 ^{*1}	59,940	✓	✓	-
1920 × 1080 ^{*1}	60,000	✓	✓	✓

*1 Doporučené rozlišení

Poznámka

- Je podporováno pouze progresivní obnovování obrazu.

4.3 Příslušenství

Aktuální informace o volitelném příslušenství a o nejnovějších kompatibilních grafických adaptérech naleznete na našem webu.

(www.eizoglobal.com)

Příloha

Zdravotnická norma

- U finálního systému je třeba zajistit soulad s požadavky normy IEC 60601-1-1.
- Elektrická zařízení mohou vyzařovat elektromagnetické vlny, které mohou monitor ovlivnit, omezit jeho funkce nebo způsobit jeho nesprávné chování. Instalujte přístroj v kontrolovaném prostředí, kde k této jevům nebude docházet.

Klasifikace zařízení

- Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída I
- Třída EMC: IEC60601-1-2:2014 skupina 1, třída B
- Klasifikace zdravotnického prostředku (EU): Třída I
- Režim provozu: Trvalý

Informace o elektromagnetické kompatibilitě

Základní funkcí přístrojů řady RadiForce je zobrazování obrazů.

Prostředí, pro které je tento produkt určen

Řada RadiForce je určena pro použití v odborném zdravotnickém prostředí, jako jsou kliniky a nemocnice. Řada RadiForce není vhodná pro použití v následujících prostředích:

- Poskytování domácí zdravotní péče
- V blízkosti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení, například elektrochirurgických nožů
- V blízkosti krátkovlnného terapeutického vybavení
- Místnost se stíněním vysokofrekvenčních systémů lékařského vybavení pro MRI
- Ve zvláštních stíněných prostředích
- Instalace ve vozidlech, včetně sanitek
- Další speciální prostředí



VAROVÁNÍ

- Zařízení řady RadiForce vyžadují zvláštní opatření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu a je nutné je instalovat. Je třeba, abyste si pečlivě přečetli informace o elektromagnetické kompatibilitě a část „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ v tomto dokumentu a při instalaci a používání tohoto výrobku dodržovali následující pokyny.



VAROVÁNÍ

- Zařízení řady RadiForce se nesmí používat v blízkosti nebo položený na jiných zařízeních. Je-li nutné používat zařízení v blízkosti jiných zařízení nebo je nutné skládat tato zařízení na sebe, je nutné zařízení sledovat a kontrolovat, zda v dané konfiguraci pracují správně.



VAROVÁNÍ

- Používané přenosné vysokofrekvenční komunikační zařízení udržujte 30 cm (12 palců) nebo více od jakékoli části zařízení řady RadiForce včetně kabelů. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto vybavení.



VAROVÁNÍ

- Pokud ke vstupu nebo výstupu signálu výrobku připojujete další zařízení a používáte výrobek jako součást lékařského systému, musíte zajistit soulad s požadavky normy IEC/EN60601-1-2.

 VAROVÁNÍ				
<ul style="list-style-type: none"> Použijte kabely dodané s tímto výrobkem nebo kabely specifikované společností EIZO. <p>V případě použití jiných kabelů, než které jsou specifikované společností EIZO, by mohlo dojít ke zvýšení elektromagnetického rušení nebo narušení funkce tohoto přístroje elektromagnetickým rušením.</p>				

Kabel	Kabely specifikované společností EIZO	Max. délka kabelu	Stínění	Feritové jádro
Signálový kabel (DisplayPort)	PP300/PP200	3 m	Stíněno	S feritovým jádrem
Signálový kabel (HDMI)	HH300PR / HH200HS	3 m	Stíněno	S feritovým jádrem
Signálový kabel (D-Sub)	V55 / MD-C87	1,8 m	Stíněno	S feritovým jádrem
Kabel USB	UU300SS/ UU200SS	3 m	Stíněno	S feritovým jádrem
Napájecí kabel (s uzemňovacím vodičem)	-	3 m	Nestíněno	Bez feritového jádra

Technický popis

Elektromagnetické emise

Zařízení řady RadiForce jsou určena k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí.

Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v popsáném prostředí.

Test emisí	Shoda	Doporučení k elektromagnetickému prostředí
Emise vysokofrekvenčního záření CISPR 11/EN 55011	Skupina 1	Zařízení řady RadiForce využívají vysokofrekvenční záření pouze pro své interní funkce. Proto jsou jejich emise vysokofrekvenčního záření velmi nízké a není pravděpodobné, že by působily jakékoli rušení elektronických zařízení ve svém okolí.
Emise vysokofrekvenčního záření CISPR 11/EN 55011	Třída B	Zařízení řady RadiForce jsou vhodná k použití ve všech typech budov včetně obytných budov a budov, které jsou přímo připojeny k veřejné nízkonapěťové elektrorozvodné síti určené k napájení obytných budov.
Emise harmonického proudu IEC/EN 61000-3-2	Třída D	
Emise v důsledku kolísání napětí a flikru IEC/EN 61000-3-3	Shoda	

Elektromagnetická odolnost

U řady RadiForce byly testovány následující úrovně kompatibility podle požadavku testování pro profesionální zdravotnická zařízení určená v normě IEC/EN60601-1-2.

Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v popsaném prostředí.

Zkouška odolnosti	Zkušební úroveň pro profesionální zdravotnická zařízení	Úroveň shody	Doporučení k elektromagnetickému prostředí
Elektromagnetické výboje IEC/EN 61000-4-2	±8 kV vybití kontaktem ±15 kV vybití vzduchem	±8 kV vybití kontaktem ±15 kV vybití vzduchem	Podlahy musejí být ze dřeva, betonu nebo keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy pokryty syntetickým materiélem, musí relativní vlhkost vzduchu činit alespoň 30 %.
Rychlé elektrické přechodné jevy/ skupiny impulzů IEC/EN 61000-4-4	±2 kV napájecí vedení ±1 kV vstupní/ výstupní vedení	±2 kV napájecí vedení ±1 kV vstupní/ výstupní vedení	Kvalita napájení by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Rázové impulsy IEC/EN 61000-4-5	±1 kV mezi vedeními ±2 kV mezi vedením a zemí	±1 kV mezi vedeními ±2 kV mezi vedením a zemí	Kvalita napájení by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a změny napětí na vstupních napájecích vedeních IEC/EN 61000-4-11	0 % U_T (100 % pokles U_T) po dobu 0,5 cyklu a 1 cyklu 70 % U_T (30 % pokles v U_T) po dobu 25 cyklů při 50 Hz 0 % U_T (100 % pokles v U_T) po dobu 250 cyklů při 50 Hz	0 % U_T (100 % pokles U_T) po dobu 0,5 cyklu a 1 cyklu 70 % U_T (30 % pokles v U_T) po dobu 25 cyklů při 50 Hz 0 % U_T (100 % pokles v U_T) po dobu 250 cyklů při 50 Hz	Kvalita napájení by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel zařízení řady RadiForce požaduje trvalý provoz i během přerušení dodávky proudu, doporučujeme napájet zařízení řady RadiForce pomocí nepřerušitelného zdroje napájení nebo baterie.
Magnetická pole síťového kmitočtu IEC/EN 61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Magnetická pole síťového kmitočtu musejí na všech úrovních odpovídat charakteristikám typické lokality v komerčním nebo nemocničním prostředí. Tento výrobek musí být během používání udržován alespoň 15 cm od magnetických polí síťového kmitočtu.

Zkouška odolnosti	Zkušební úroveň pro profesionální zdravotnická zařízení	Úroveň shody	Doporučení k elektromagnetickému prostředí
Rušení indukované vysokofrekvenčními poli IEC/EN 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms Pásma ISM mezi 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Přenosná a mobilní zařízení pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření nesmí být používána v blízkosti jakýchkoli součástí zařízení řady RadiForce včetně kabelů. Minimální vzdálenost musí odpovídat vzdálenosti vypočítané z příslušné rovnice pro kmitočet vysílače. Doporučený odstup $d = 1,2\sqrt{P}$
Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole IEC/EN61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Platí, že „P“ je maximální vysílací výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a „d“ je doporučená vzdálenost v metrech (m). Síla pole pevných vysokofrekvenčních vysílačů zjištěná průzkumem ¹ elektromagnetického prostředí musí být menší než úroveň shody pro jednotlivé kmitočtové rozsahy ² . V blízkosti zařízení označených následujícím symbolem může dojít k rušení. 

Poznámka

- U_T znamená střídavé napětí hlavního napájení před aplikací zkušební úrovně.
- Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
- Zásady ohledně rušení šířeného vysokofrekvenčními poli nebo vyzařovanými vysokofrekvenčními poli nemusejí v některých situacích platit. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.
- Pásma ISM mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

¹ Sílu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro mobilní telefony a vysílačky, amatérské radiostanice, rozhlasové stanice v pásmech AM a FM a televizní stanice, nelze podle teorie přesně předpovídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí s ohledem na pevné vysokofrekvenční vysílače je vhodné provést průzkum elektromagnetického prostředí. Pokud změřená síla pole v lokalitě, kde je používáno zařízení řady RadiForce, přesahuje příslušnou výše uvedenou úroveň shody s vysokofrekvenčním zářením, je třeba zařízení řady RadiForce pozorovat a kontrolovat, zda pracuje správně. Je-li zjištěno neobvyklé chování, může být nutné přijmout další opatření jako je změna orientace nebo umístění zařízení řady RadiForce.

² Při kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být síla pole menší než 3 V/m.

Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření a zařízeními řady RadiForce

Zařízení řady RadiForce jsou určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolované. Uživatel zařízení řady RadiForce může předcházet elektromagnetickému rušení zachováváním níže doporučené minimální vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílači) a zařízeními řady RadiForce. Byla ověřena odolnost vůči blízkým polím z následujícího vysokofrekvenčního bezdrátového komunikačního vybavení:

Zkušební frekvence (MHz)	Šířka pásma ^{*1} (MHz)	Služba ^{*1}	Modulace ^{*2}	Maximální výkon (W)	Minimální vzdálenost (m)	Zkušební úroveň podle normy IEC/EN60601 (V/m)	Úroveň shody (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Pulzní modulace ^{*2} 18 Hz	1,8	0,3	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM odchylka ±5 kHz sinusový signál 1 kHz	2	0,3	28	28
710	704–787	Pásma LTE 13, 17	Pulzní modulace ^{*2} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800–960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pásmo 5	Pulzní modulace ^{*2} 18 Hz	2	0,3	28	28
870							
930							
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pásmo 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulzní modulace ^{*2} 217 Hz	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pásmo 7	Pulzní modulace ^{*2} 217 Hz	2	0,3	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzní modulace ^{*2} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

^{*1} Pro některé služby jsou uvedeny pouze odesílací frekvence.

^{*2} Nosná frekvence je modulována pomocí signálu obdélníkové vlny 50% pracovního cyklu.

Zařízení řady RadiForce jsou určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolované. Pro ostatní mobilní zařízení pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílače) v minimální vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílači) a zařízeními řady RadiForce v souladu s maximálním vysílacím výkonem komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální vysílací výkon vysílače (W)	Vzdálenost podle kmitočtu vysílače (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pro vysílače s maximálním vysílacím výkonem, který zde není uveden, platí, že doporučenou vzdálenost „d“ v metrech (m) lze odhadnout pomocí rovnice příslušné pro kmitočet vysílače, kde „P“ je maximální jmenovitý vysílací výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače.

Poznámka

- Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost vyšší kmitočtový rozsah.
- Tato doporučení nemusejí být platná ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EC REP

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited

UK Responsible Person

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG

CH REP

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

UK
CA
CE

03V60136B1
IFU-MS236WT-A